

## RAPPORT INDIVIDUEL DE COMPARAISON INTERLABORATOIRES



### 19H - PESTICIDES - FRUITS ET LÉGUMES : DITHIOCARBAMATES

---

Ce rapport ne peut pas être dissocié du rapport général dont il est issu

Adhérent : 14743

Code édition : C3673

Laboratoire : AGQ MAROC SARL

Adresse : Zone Industrielle Sud Ouest,  
N°152

Ville : MOHAMMEDIA

Pays : Maroc

Essai : 5 / 2022

Matrice : Tomate Dithiocarbamates  
Tomate Dithiocarbamates

Rapport n° : 822

Campagne : 2021 - 2022

N° d'essai : 29

## SOMMAIRE

RÉSULTATS DE VOTRE LABORATOIRE	<b>3</b>
SYNTHESE GLOBALE DE L'APTITUDE DE VOTRE LABORATOIRE	3
RESULTATS DE VOTRE LABORATOIRE	3
COMMENTAIRE	3
Tomate Dithiocarbamates - Echantillon 5919	<b>4</b>
PERFORMANCE PAR CRITERE	<b>4</b>
Dithiocarbamates - Résultat exprimé en CS2	5
LEGENDE DES TABLEAUX	<b>6</b>
ATTESTATION DE PARTICIPATION CIL BIPEA	<b>7</b>

## RÉSULTATS DE VOTRE LABORATOIRE

---

### SYNTHESE GLOBALE DE L'APTITUDE DE VOTRE LABORATOIRE

Jugement	Nombre de critères analytiques
Satisfaisant	1
A surveiller	0
Insatisfaisant	0
Non évalué	0

### RESULTATS DE VOTRE LABORATOIRE

Critère analytique	Unité	Valeur assignée	Ecart-type pour l'évaluation de d'aptitude	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
Dithiocarbamates Résultat exprimé en CS2	mg.kg <sup>-1</sup>	0,993	0,204	1,050	0,28	Satisfaisant


### COMMENTAIRE

## Tomate Dithiocarbamates - Echantillon 5919

## PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

### Dithiocarbamates - Résultat exprimé en CS2


Carte de suivi de la justesse : Dithiocarbamates

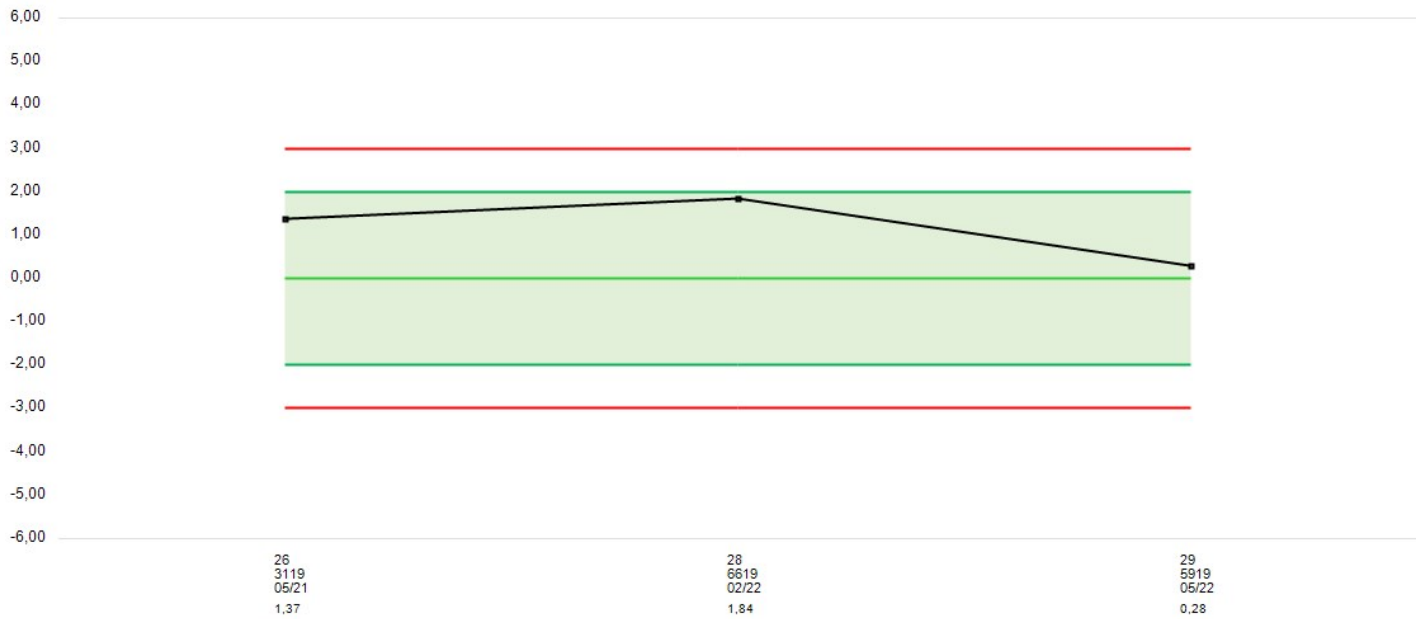

Résultats par méthode : Dithiocarbamates

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
Spectrophotométrie UV	mg.kg <sup>-1</sup>	1,050	0,28	Satisfaisant

Histogramme : Dithiocarbamates



## LEGENDE DES TABLEAUX

---

### SYNTHESE GLOBALE de l'APTITUDE de votre LABORATOIRE

Le code édition est celui de la campagne en cours et est consultable sur le site internet du Bipea, Rubrique « espace adhérent ».

x                    Résultat

Résultat de mesurage ou d'essai.

z                    z-score

Expression du résultat du laboratoire sous forme de chiffre sans unité, calculé à partir de la valeur assignée et de la moitié de la valeur de tolérance.

**Satisfaisant** :      Résultat juste

Résultat compris dans l'intervalle de tolérance et dont le z-score est inférieur ou égal à 2,0 en valeur absolue. Cette qualification correspond à une performance acceptable lors de l'évaluation de l'aptitude, au regard des choix de la Commission technique.

**A surveiller** :      Résultat non juste

Résultat hors de l'intervalle de tolérance et dont le z-score est supérieur à 2,0 et inférieur à 3,0 en valeur absolue. Cette qualification correspond à un signal d'avertissement lors de l'évaluation de l'aptitude, au regard des choix de la Commission Technique.

**Insatisfaisant** :    Résultat non juste

Résultat hors de l'intervalle de tolérance et dont le z-score est supérieur ou égal à 3,0 en valeur absolue. Cette qualification correspond à un signal d'action lors de l'évaluation de l'aptitude, au regard des choix de la Commission Technique.

**Non évalué**

Aucune statistique de performance ne peut être déterminée.

**13.57**                Résultat incohérent

Résultat ne participant pas aux estimations et dont le jugement sur l'aptitude est suspendu. Le résultat est éliminé par les tests de cohérence entre les valeurs. Ce résultat est généralement considéré comme insatisfaisant.

< 13.57              Limite de quantification

Valeur de la limite de quantification du laboratoire. Cette valeur ne peut être intégrée ni dans les estimations des moyennes et écart-types, ni jugée par rapport à l'intervalle de tolérance.

LD LQ                Limites de détection et de quantification.

Note : Pour des compléments d'information, voir le RCIL définitif complet originel envoyé par le Bipea par courrier électronique. Ce dernier est le seul qui fait foi.

## ATTESTATION DE PARTICIPATION CIL BIPEA

[==ATTESTATION-DEBUT==]

### ATTESTATION DE PARTICIPATION CIL BIPEA

Je soussignée, Caroline LAURENT, Directeur du BIPEA, certifie que :

L'établissement : **AGQ MAROC SARL**

Adresse : Zone Industrielle Sud Ouest, N°152

Ville : MOHAMMEDIA

Pays : Maroc

Code adhérent : **14743**

---

RAPPORT INDIVIDUEL

A participé à l'essai interlaboratoires :

Circuit : 19H PESTICIDES - FRUITS ET LÉGUMES : DITHIOCARBAMATES  
Matrice : Tomate DithiocarbamatesTomate Dithiocarbamates  
Essai : 5 / 2022

Et a obtenu les résultats suivants :

Critère analytique	Unité	Valeur assignée	Ecart-type pour l'évaluation de d'aptitude	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
Dithiocarbamates Résultat exprimé en CS2	mg.kg <sup>-1</sup>	0,993	0,204	1,050	0,28	Satisfaisant

Fait à Paris, le lundi 20 juin 2022

Caroline LAURENT

Directeur du BIPEA  
[==ATTESTATION-FIN==]